

Научно производственное предприятие «Техприбор»

Структуроскоп термоэлектрический «Метэк»

ПАСПОРТ
(руководство по эксплуатации)

ТНДТ.401.564.02РЭ

г. Энгельс
2016

Содержание

1	Назначение.....
2	Технические характеристики.....
3	Комплектность.....
4	Устройство и принцип работы.....
5	Подготовка к работе.....
6	Порядок работы.....
7	Калибровка прибора.....
8	Техническое обслуживание.....
9	Возможные неисправности и способы их устранения.....
10	Свидетельство о приёмке.....
11	Гарантийные обязательства.....
12	Маркирование и пломбирование.....
13	Правила хранения и транспортирования.....

Настоящий паспорт ТНДТ.401.564.02РЭ на структуроскоп термоэлектрический «Метэк» (далее - прибор), выпускаемый согласно СНИИМ.401564.002ТУ, включает в себя, технические характеристики, а также сведения для изучения конструкции, принципа действия и правил эксплуатации, транспортирования и хранения прибора.

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

1. Назначение

Прибор предназначен для измерения постоянного напряжения при неразрушающем контроле поверхностного слоя изделий из электропроводящих материалов термоэлектрическим методом.

Прибор может использоваться для:

- сортировки металлов или сплавов по маркам,
- определения процентного содержания компонента в сплаве,
- определение режимов термообработки,
- определение структурной неоднородности.

2. Технические характеристики.

Прибор рассчитан на применение в лабораторных и цеховых условиях различных отраслей промышленности.

- температура окружающего воздуха от 0°C до +35°C.
- относительная влажность воздуха до 98%.
- атмосферное давление от 70 до 106,7КПа.

По рабочим условиям применения и предельным условиям транспортирования прибор относится к группе 4 по ГОСТ 22261-94.

Диапазон измерения напряжения , мкВ	± 2000
Погрешности измерения напряжения (без нагрева), не хуже	мкВ ±2
Погрешности измерения напряжения (с нагревом) , не хуже мкВ	±20
Напряжение питания от сети переменного тока В, Гц	220, 50
Потребляемая мощность, не более Вт	7,5
Готовность к работе, не более мин	2
Время анализа одного образца, не более сек	6
Локальность контролируемого участка мм	0,5
Температура горячего электрода, не менее °С	40
Температура горячего электрода, не более °С	90
Точность стабилизации температуры, не хуже °С	±2
Время непрерывной работы от аккумулятора, не менее час	2
Габаритные размеры (Ш x Д x В),мм	65 x 125 x 20
Масса без блока питания кг	0,25
Средняя наработка на отказ, не менее ч	8000
Средний срок службы, не менее лет	5

Прибор снабжён цветным графическим дисплеем с разрешением 320 на 240 точек.

На дисплее отображается измеренное значение величины ТермоЭДС, минимальное, максимальное и среднеквадратичное значение за серию измерений, коэффициент вариации измеренных значений за серию измерений, значение эталона и допуска для сигнализации отклонения. Восемь предыдущих измеренных величин ТермоЭДС. Так же на дисплее отображается состояние встроенного аккумулятора и температура горячего и холодного электрода.

Прибор обеспечивает звуковую и цветовую индикацию при превышении заданного уровня.

Электрическое питание прибора осуществляется от сети переменного тока или от встроенного аккумулятора, продолжительность непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора не менее 2ч.

Прибор имеет функцию автоматического отключения при перерыве в работе, время работы прибора до отключения устанавливается оператором. Перерывом в работе является временная пауза между нажатием любых кнопок или электрического контакта горячего электрода с холодным во время измерения.

3. Комплектность

Электронный блок	1 шт.
Сетевой блок питания	1 шт.
Датчик с горячим и холодным электродами	1 шт.
Паспорт (руководство по эксплуатации)	1 шт.
Контрольный образец напряжения	1 шт.
Кейс (сумка) для транспортировки	1 шт.

4. Устройство и принцип работы

В 1821 г. Томас Зеебек установил, что в цепи, состоящей из двух разнородных проводников, возникает разность потенциалов, если контакты этих проводников поддерживаются при различных температурах. Эта разность потенциалов получила название термоэлектродвижущей силы (термоЭДС). Данная термоЭДС, возникающая в неоднородных проводящих контурах на основе эффекта Зеебека, может быть использована для исследования различных металлов и сплавов термоэлектрическим методом. При этом методе измеряется термоЭДС, которая возникает между острием измерительного зонда с известными термоэлектрическими свойствами и исследуемым материалом. Термоэлектрический потенциал имеет высокую чувствительность к малейшим изменениям в электронном энергетическом спектре. Рассматриваемый метод основан на том, что добавление даже десятых долей % примеси может привести к изменению термоЭДС на сотни процентов. Различные дефекты вносят разный вклад в термоЭДС не только по величине, но и по знаку, а это создает возможность использования термоэлектрической движущей силы в качестве параметра, характеризующего концентрацию примесей, упругие напряжения и фазовые превращения. Поэтому термоэлектрический метод находит все более широкое применение в решении задач неразрушающего контроля, в частности, он используется при контроле химического состава, для сортировки сплавов по маркам, определения процентного содержания компонента в сплаве, структуры материала, режимов термообработки.

Принцип работы прибора «Метэк» основан на измерении величины термоЭДС возникающей при контакте нагретого до определенной температуры измерительного (горячего) электрода и поверхности контролируемой детали контактирующей с холодным электродом.

Температура горячего электрода поддерживается автоматически относительно температуры окружающей среды (холодного электрода). Необходимая разница температур устанавливается оператором. Рекомендуемая разница температур 50°C. (при температуре окружающей среды 25°C горячий электрод будет нагрет до 75°C)

Величина измеряемой термоЭДС отображается в милливольтках.

Конструктивно прибор включает в себя электронный блок, выполненный в корпусе из алюминия и ударопрочного пластика и измерительного преобразования с горячим и холодным электродами, подключаемые к электронному блоку через самозащелкивающийся разъем с помощью гибкого кабеля.

Электронный блок включает в себя электрическую схему обеспечивающую измерение сигналов с подключаемых преобразователей, обработку этих сигналов и индикацию результата на цветном графическом дисплее.

На передней панели прибора расположены:

- графический дисплей, предназначенный для отображения результатов измерения и другой информации, необходимой для работы с прибором,
- клавиатура из четырёх кнопок управления с соответствующей символикой.

На верхнем торце прибора расположен разъём для подключения блока измерительных электродов и разъём для подключения блока питания и заряда встроенного аккумулятора.

На нижнем торце прибора расположен разъём, совместимый с miniUSB, для подключения устройства заряда встроенного аккумулятора.

На задней панели прибора имеется маркировка типа прибора, серийный номер и год выпуска.

5. Подготовка к работе

В приборе не используются напряжения, опасные для жизни и здоровья человека. Прибор обслуживается одним человеком (оператором), изучившим настоящее руководство по эксплуатации.

Если прибор внесен в помещение после пребывания при температуре окружающей среды ниже 0°C, он должен быть выдержан в нормальных условиях в выключенном состоянии не менее 2 ч.

В случае резкого изменения (перепада) температуры окружающей среды на величину более 10°C необходимо выдержать прибор в рабочих условиях эксплуатации в выключенном состоянии не менее 30 мин.

Произвести внешний осмотр прибора, проверить целостность прибора, соединительного кабеля и преобразователя.

Подключить блок измерительных электродов к разъёму прибора, находящемуся на верхнем торце.

Подключить внешний блок питания и включить его в сеть переменного тока.

Нажать кнопку «ВКЛ» и удерживать её несколько секунд до включения прибора.

После включения прибора показания графического дисплея будут соответствовать рис.1 .

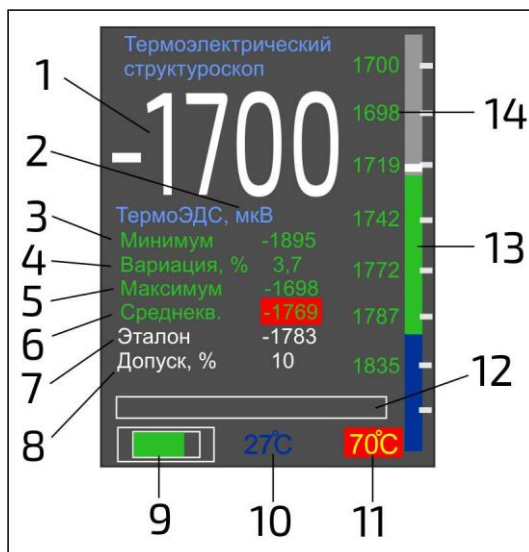


Рис.1

Цифрами на рисунке обозначены:

1. измеренное значение величины термоЭДС.
2. единица измерения (мкВ –микровольты)
3. минимальное значение термоЭДС в мкВ.
4. Коэффициент вариации в %.
5. максимальное значение термоЭДС.
6. среднеквадратичное значение из серии измерений в мкВ.
7. установленное эталонное значение в мкВ.
8. установленное значение допустимого отклонения в %
9. индикатор состояния аккумулятора.
10. температура окружающей среды в °С.
11. температура преобразователя в °С.
12. гистограмма хода процесса измерения
13. гистограмма температуры
14. восемь измеренных значений термоЭДС в мкВ

На передней панели прибора расположены четыре кнопки;

ОК – короткое нажатие открывает доступ к меню выбора параметров и режимов работы прибора, долгое нажатие (нажатие более 3 секунд) сохраняет измеренное значение термоЭДС как значение эталона.

Вверх – короткое нажатие увеличивает величину допустимого отклонения.

Вниз – короткое нажатие уменьшает величину допустимого отклонения, долгое нажатие стирает все измеренные значения, текущее, среднее и коэффициент вариации.

ВКЛ - долгое нажатие выключает прибор, короткое включает.



Рис.2

При коротком нажатии кнопки ОК открывается доступ к меню выбора параметров и режимов работы, доступны следующие пункты, указанные на рис.2

ТЕМПЕРАТУРА – при выборе этого пункта устанавливается разница температуры горячего электрода и окружающей среды. Для установки значения необходимо воспользоваться кнопками «вверх» и «вниз» короткое нажатие на «вниз» меняет разряд, «вверх» увеличивает значение разряда на единицу. Выход из режима, кнопка «ОК».

ЗВУК - включение/выключение звуковой сигнализации.

АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ - установка автоматического выключения прибора при достижении определенного времени 1,5,10 минут.

ЯРКОСТЬ изменение яркости подсветки дисплея.

РЕЖИМ – дополнительное меню установки режимов работы.

Содержание меню РЕЖИМ представлено на рис. 3

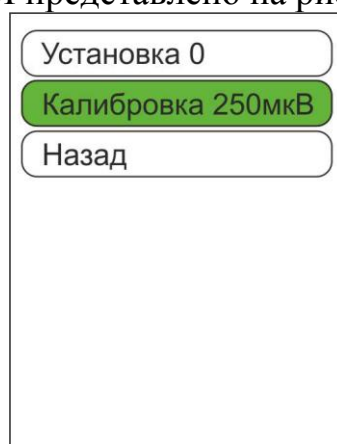


Рис. 3

УСТАНОВКА 0 - Используется для установки нулевого значения при нулевом потенциале на измерительных электродах. Используется при калибровке.

КАЛИБРОВКА – калибровка по образцу 250мкВ.

При изменении любого параметра или режима их значения сохраняются во внутренней памяти и не сбрасываются при выключении.

После включения прибора начинается нагрев измерительного горячего электрода, процесс нагрева отображается изменением цвета гистограммы 12. Численное значение температуры 3 изменит цвет при достижении заданного значения. (с красного на зеленый) По умолчанию установлена температура на 50°C выше температуры холодного электрода, при необходимости возможно установить разницу температур от 5°C до 55°C.

После достижения заданной температуры, индикация температуры будет подсвечена зеленым, прибор готов к работе.

6. Порядок работы

Измерение термоЭДС осуществляется автоматически при электрическом контакте холодного и горячего электрода с поверхностью контролируемого образца. Для измерения необходимо обеспечить электрический контакт холодного электрода и изделия, прикоснутся горячим электродом к измеряемой поверхности при этом прижать преобразователь к поверхности до упора. Давление горячего электрода на поверхность контролируемой детали не оказывает влияние на измерение, так как горячий электрод прижимается к поверхности не усилием оператора, а пружиной с установленным давлением 2кг.

Для исключения нагрева холодного электрода от тепла, рассеваемого горячим электродом необходимо обеспечить необходимое минимальное расстояние между электродами, не менее 5мм. Измерение начинается с паузы примерно в 0,5с, для исключения влияния «дребезга контактов», процесс измерения отображается гистограммой на дисплее и завершается звуковым сигналом (если включена звуковая сигнализация) и отображением результата. Если во время измерения электрический контакт нарушается, измерение повторяется автоматически.

На результат измерения термоЭДС влияют следующие факторы:

- плохой контакт между измерительными электродами и поверхностью металла,
- изменение разности температур горячего электрода и контролируемой детали.

Для исключения влияния этих факторов и обеспечения достоверности оценки на поверхности металла должны отсутствовать посторонние фракции, такие как коррозия, окалина, органические покрытия и др. При наличии таковых поверхность металла нужно предварительно подготовить до их полного удаления, обработав напильником, наждаком или другими средствами, предназначенными для механической обработки. Обработка поверхности необходима только в точке касания контактных групп с образцом металла.

Запрещено!

Работать с образцами металлов находящихся под напряжением!

Для исключения влияния нестабильности температуры контролируемая деталь должна быть выдержана при той же температуре что и холодный электрод, не менее 20-30мин, в зависимости от размера детали.

При измерении касаться горячим электродом контролируемой поверхности уверенным касанием.

Рекомендуется произвести несколько измерений, восемь последних значений будут отображаться на дисплее. При каждом измерении на дисплее будет пересчитываться минимальное и максимальное значение из этой серии измерений, среднеквадратичное значение и коэффициент вариации, статистическая величины отражающая однородность данных в серии измерений, рекомендуется считать измерения однородными, если коэффициент вариации не превышает 5%.

Определение марки металла, или выделения отличий по химическому составу, по режиму термообработки производится путём сравнения значения термоЭДС с термоЭДС контрольного образца или образца с известными характеристиками.

Контрольный образец это заготовка (деталь) с известными параметрами с однородным химическим составом и структурой.

Для сравнения с контрольным образцом необходимо произвести серию измерений на поверхности контрольного образца, при этом коэффициент вариации должен быть минимальным. Затем длительным нажатием на кнопку ОК сохранить значение эталона (сохранится или значение последнего измерения или среднеквадратичное из серии измерений в зависимости от установленного режима, рекомендуется среднеквадратичное значение).

Перед следующей серией измерений на поверхности контролируемой детали необходимо очистить предыдущие значения длительным нажатием на кнопку вниз. Произвести следующие несколько измерений, если отклонение от эталона превысят допустимое отклонение они будут отображаться на дисплее красным цветом. При этом можно утверждать что измеряемая деталь имеет отличия химического состава или поверхностный слой имеет иную структуру, отличную от контрольного образца. Следует отметить, что на величину термоЭДС в большей степени влияет поверхностный слой, глубиной порядка 100мкм. Термоэлектрический метод контроля, кроме его высокой чувствительности к параметрам структуры и химическому составу, характеризует высокая локальность, которая определяется размером нагреваемой области, при этом форма и размеры всей детали на измерение не оказывают влияния.

7. Калибровки прибора

Калибровка проводится согласно пункта 8.4 настоящего руководства. Прибор подлежит калибровке с интервалом 1 год.

В процессе эксплуатации есть возможность проконтролировать показания прибора по контрольному образцу напряжения, входящему в комплект поставки.

На корпусе контрольного образца находятся контакты «минус» и «плюс» прецизионного источника напряжения величиной 250мкВ, переключатель включения контрольного образца и пластина образец из сплава МН15-20.

8. Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание прибора состоит из профилактического осмотра, текущего ремонта и калибровки.

8.2 Профилактический осмотр производится обслуживающим персоналом перед началом работы и включает:

- внешний осмотр;
- проверку работоспособности органов управления и коммутации;
- проверку целостности кабеля преобразователя.

8.3 Текущий ремонт прибора производится в ходе эксплуатации прибора на, при этом устраняются неисправности, замеченный при профилактическом осмотре, путём замены или восстановления отдельных частей прибора (замена радиоэлементов, восстановление нарушенных связей и т. п.), Ремонт прибора производится на предприятии изготовителе.

8.4 Калибровка прибора производится в соответствии с методикой калибровки МК-002АВЗ-16 органами государственной метрологической службы или органами метрологических служб эксплуатирующих организаций, аккредитованных Госстандартом России на правил проведения калибровки средств измерений электрических величин.

9. Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице.

Наименование неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
1	2	3
Прибор не включается	Разряжена батарея	Зарядить батарею, подключив зарядное устройство
Прибор не реагирует на подключение преобразователя	Обрыв соединительного кабеля. Неисправен преобразователь	Заменить преобразователь

10. Свидетельство о приёмке

Термоэлектрический структуроскоп «Метэк» заводской номер _____, соответствует техническим условиям СНИИМ.401564.002ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

11. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям СНИИМ.401564.002ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, а также работ по техническому обслуживанию, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения– 6 месяцев со дня изготовления прибор.

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать прибор вплоть до замены его в целом, если за этот срок прибор выйдет из строя или его характеристики окажутся ниже норм, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

Безвозмездный ремонт прибора производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

12. Маркирование и пломбирование

На передней панели электронного блока нанесена маркировка, содержащая:

- надпись «Структроскоп термоэлектрический МЕТЭК»;
- товарный знак предприятия-изготовителя;

На задней стенке электронного блока нанесена маркировка, содержащая:

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя и год выпуска

- надпись «Структроскоп термоэлектрический МЕТЭК»
- Наименование предприятия изготовителя, город, телефон

13. Правила хранения и транспортирования

Прибор в течение гарантийного срока хранения должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +10 до +35°C, относительной влажности воздуха до 80 % при температуре +35 °С. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию и разрушающих покрытия и изоляцию.

Прибор, освобожденный от транспортной упаковки, должен храниться при температуре окружающего воздуха от +10 до +35°C, относительной влажности до 80 % при температуре +25°C.

Прибор должен транспортироваться упакованным в транспортный ящик. При транспортировании ящик должен быть закреплен и защищен от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Прибор может транспортироваться в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах, автомашинах, в трюмах судов, отапливаемых герметизированных отсеках самолетов при температуре от -25 до +55°C и относительной влажности воздуха до 90% при температуре +25 °С.

Транспортирование производить в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.