

Қазақстан Республикасының
Сауда және интеграция
министрлігі



Министерство торговли и
интеграции Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Комитет
технического регулирования и
метрологии"

"Техникалық реттеу және
метрология комитеті"
республикалық мемлекеттік
мекемесі

Нұр-Сұлтан қ.

г.Нур-Султан

Нөмірі: KZ50VTN00006129

Берілген күні: 16.02.2022

**Өлшем құралдарының типін бекіту туралы
СЕРТИФИКАТ №1437**

16.02.2022 ж.
Қазақстан Республикасының
Өлшем бірлігін
қамтамасыз ету
мемлекеттік жүйесінің
тізілімінде
№ KZ.02.01.01437-2022
болып тіркелген
16.02.2027 жылға дейін
жарамды*

Осы сертификат сынақтардың оң нәтижелерінің негізінде
Ұлыбритания

өндірістің аумақтық орналасқан жері

«Michell Instruments Ltd» фирмасы өндірген

өндірушінің атауы

Easidew, Promet, Liquidew, Condumax II, CDP, MDM, SF, HS3, PC, PF, DT, OptiPEAK
TDL, QMA, S4000, S8000, Optidew модификациялы Michell Instruments

типтің белгіленуі

Ылғалдылық пен шық нүктесін өлшеуге арналған құралдар

өлшем құралының атауы

зауыттық нөмірі (зауыттық нөмірлер диапазоны)**

тип бекітілгенін куәландырады және Қазақстан Республикасында айналымға
шығарылғанын куәландырады.

Заместитель председателя


Есенбекова Жанна Рашидовна


Ескерту:

* - Өлшем құралдарының типін бекіту кезінде толтырылады;

** - Өлшем құралдарының партия типін бекіту кезінде толтырылады.



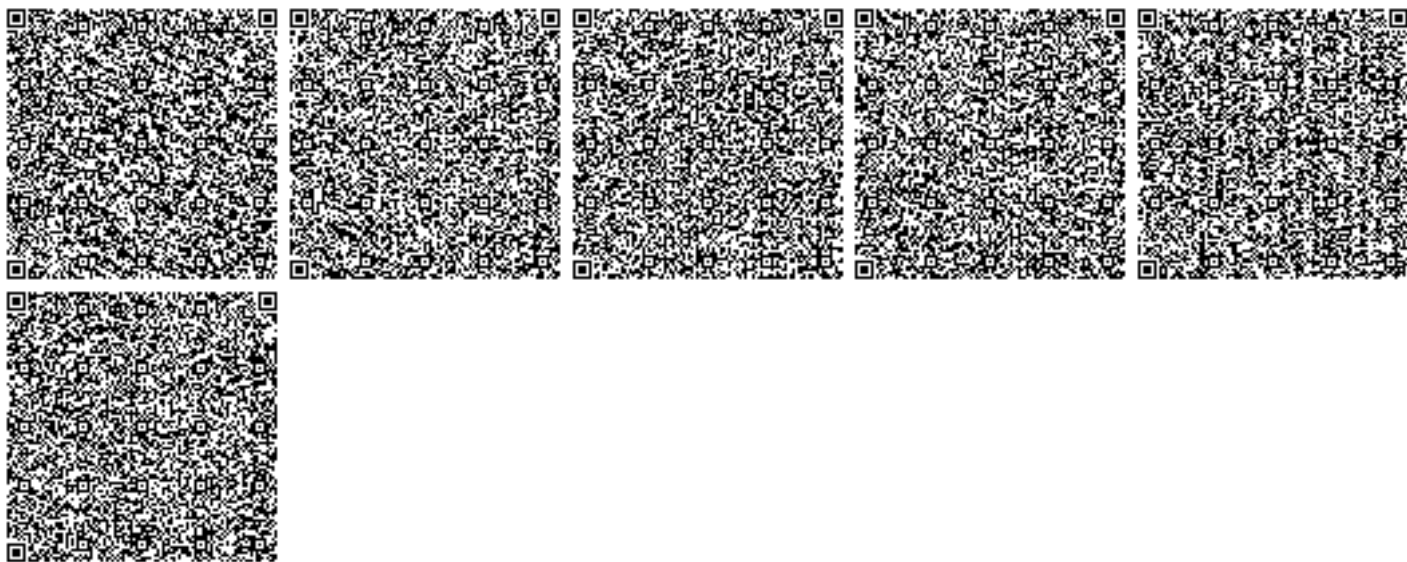

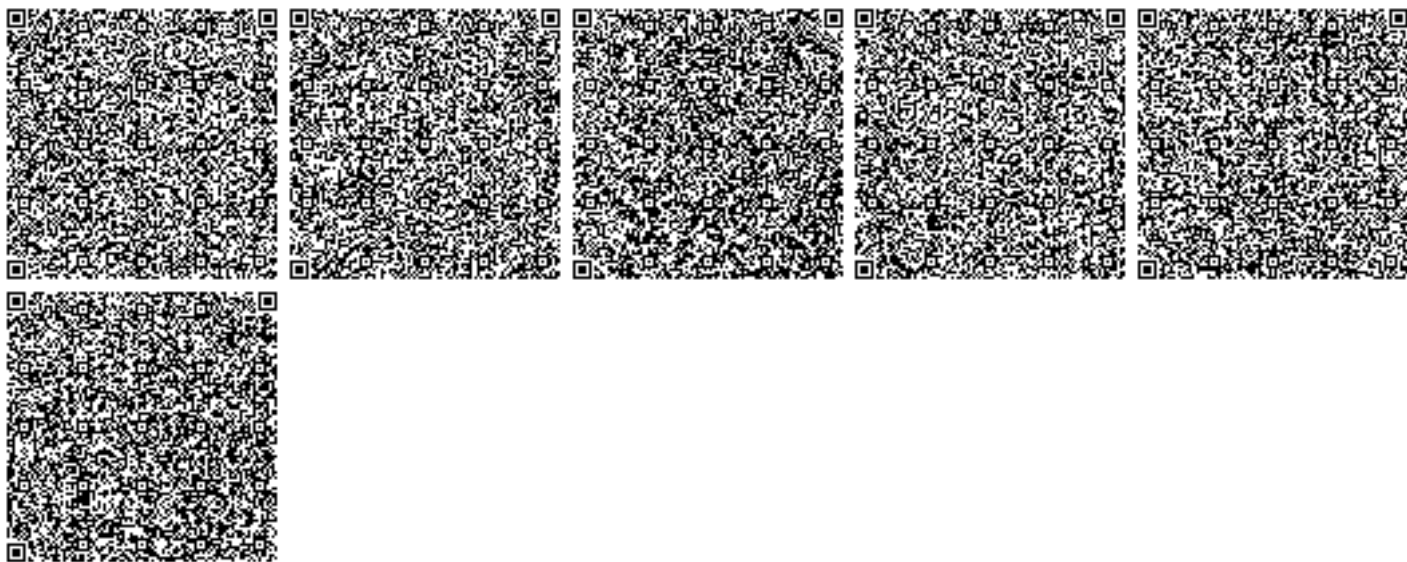

Қазақстан Республикасының
Сауда және интеграция
министрлігі



Министерство торговли и
интеграции Республики Казахстан

"Техникалық реттеу және
метрология комитеті"
республикалық мемлекеттік
мекемесі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет
технического регулирования и
метрологии"

Нұр-Сұлтан қ.

г.Нур-Султан

Номер: KZ50VTN00006129

Дата выдачи: 16.02.2022

СЕРТИФИКАТ №1437
об утверждении типа средств измерений

Зарегистрирован в
реестре государственной
системы обеспечения
единства измерений
Республики Казахстан
16.02.2022 года
за № KZ.02.01.01437-2022
Действителен до
16.02.2027 года*

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип

Приборы для измерения влажности и температуры точки росы

наименование средства измерений

Michell Instruments модификации Easidew, Promet, Liquidew, Condumax II, CDP, MDM, SF, HS3, PC, PF, DT, OptiPEAK TDL, QMA, S4000, S8000, Optidew

обозначение типа

фирма «Michell Instruments Ltd»

наименование производителя

Великобритания

территориальное место расположения производства

заводские номера (диапазон заводских номеров)**

и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан.

Заместитель председателя

Есенбекова Жанна Рашидовна

Примечание:

* - заполняется при утверждении типа средств измерений;

** - заполняется при утверждении типа партии средств измерений.

