



Держатель датчика ЛТ-ДП

Паспорт ТКЛШ 2.822.000-03 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Держатель ЛТ-ДП предназначен для крепления датчика температуры диаметром 3.3 мм электронных термометров ЛТ-300 на стенках лабораторной посуды.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Устройство и использование изделия

2.1 Внешний вид держателя показан на рисунке 1.

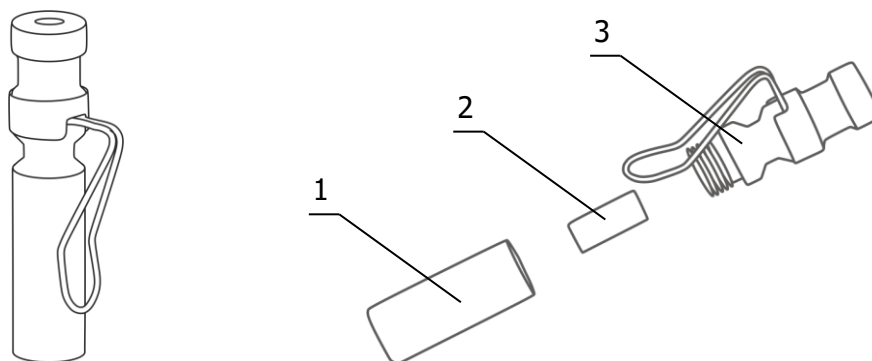


Рисунок 1 — Внешний вид изделия

2.2 Держатель изготовлен из капролона и состоит из цилиндрического корпуса 1, силиконовой трубки 2 и колпачка 3 с металлическим кольцом и пружиной. Наличие силиконовой трубки обеспечивает надежную фиксацию датчика температуры в держателе.

2.3 Для установки датчика в держатель следует:

- ослабить резьбовое соединение держателя;
- вставить датчик температуры в держатель, преодолевая сопротивление силиконовой трубки;
- зафиксировать положение датчика, затянув резьбовое соединение держателя.

3 Сведения о приемке

Держатель датчика ЛТ-ДП соответствует комплекту конструкторской документации ТКЛШ 6.152.028 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____


м.п.


ОКК _____

4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49–21–52, 49–26–31, 49–28–91, 49–01–50, 49–01–45.

 termex@termexlab.ru

 <https://termexlab.ru/>