



# Держатель датчика ЛТА-ДП

Паспорт ТКЛШ 2.822.004-01 ПС

## 1 Назначение изделия

1.1 Держатель ЛТА-ДП предназначен для крепления датчика температуры диаметром 4.3 мм электронных термометров ЛТА или ЛТ-300-Ф на стенках лабораторной посуды.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

## 2 Устройство и использование изделия

2.1 Внешний вид держателя показан на рисунке 1.

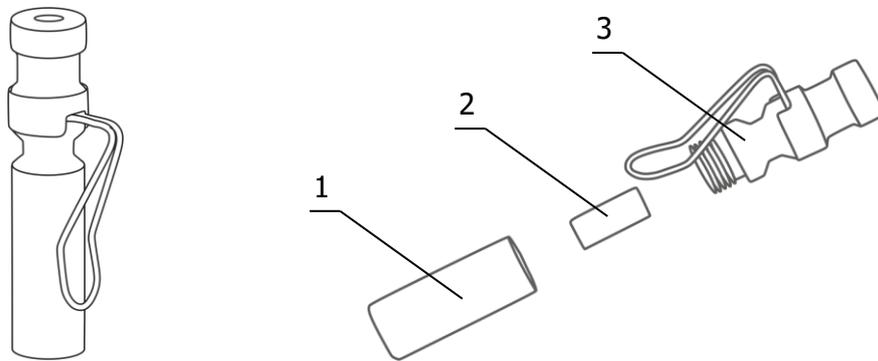


Рисунок 1 — Внешний вид изделия

2.2 Держатель изготовлен из капролона и состоит из цилиндрического корпуса 1, силиконовой трубки 2 и колпачка 3 с металлическим кольцом и пружиной. Наличие силиконовой трубки обеспечивает надежную фиксацию датчика температуры в держателе.

2.3 Для установки датчика в держатель следует:

- ослабить резьбовое соединение держателя;
- вставить датчик температуры в держатель, преодолевая сопротивление силиконовой трубки;
- зафиксировать положение датчика, затянув резьбовое соединение держателя.

## 3 Сведения о приемке

Держатель датчика ЛТА-ДП соответствует комплекту конструкторской документации ТКЛШ 6.152.028-02 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

м.п.

ОКК \_\_\_\_\_

#### 4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45.

 [termex@termexlab.ru](mailto:termex@termexlab.ru)

 <https://termexlab.ru/>