

**ЦИФРОВЫЕ БЮРЕТКИ**


Модель	UT-0110	UT-0120
Объем дозирования, мл	0,01-99,99	0,1-99,9
Максимальный объем поршня, мл	10	
Дискретность установки дозы, мл	0,01	0,1
Абсолютная погрешность, мл	±0,02	
Относительная погрешность при 10 мл	±0,2%	
Относительная погрешность при 1 мл	2%	
Температура окружающей среды	от 10°C до 30°C	
Подключение к ПК	RS-232	
Магнитная мешалка с якорем 20 мм	есть	нет
Адаптеры для бутылей с горловиной	GL32; GL38; GL25; S40	
Бутыль	опция	



**Достоинства моделей:**

- Надежная конструкция обеспечивает длительный срок эксплуатации.
- Дополнительные насадки позволяют удобно расположить устройство на рабочем столе.
- Прибор имеет пульт дистанционного управления.
- Прибор оснащен встроенной магнитной мешалкой.

**Сравнение со стеклянными бюретками:**

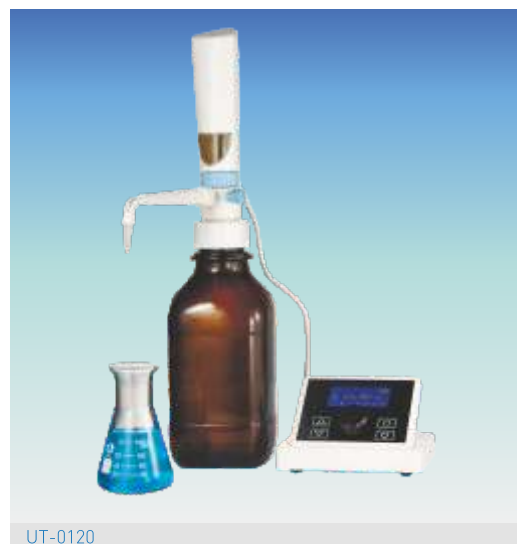

Стеклянные бюретки ГОСТ 29251-91				Цифровые бюретки ULAB®		
Объем, мл	Дискретность, мл	Погрешность, мл		Дискретность, мл		Погрешность, мл
		1-й кл.	2-й кл.	UT-0110	UT-0120	
1	0,01	±0,01	±0,02	0,01	0,1	±0,02
2	0,01	±0,01	±0,02	0,01	0,1	±0,02
5	0,02	±0,01	±0,02	0,01	0,1	±0,02
10	0,02	±0,02	±0,05	0,01	0,1	±0,02
	0,05	±0,02	±0,05	0,01	0,1	±0,02
25	0,05	±0,03	±0,05	0,01	0,1	±0,02
	0,1	±0,05	±0,1	0,01	0,1	±0,02
50	0,1	±0,05	±0,1	0,01	0,1	±0,02
100	0,2	±0,1	±0,2	0,01	0,1	±0,02