

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Газоанализаторы «АЛМАЗ-СПЕКТР»

Назначение средства измерений

Газоанализаторы «АЛМАЗ-СПЕКТР» (далее по тексту – газоанализаторы) предназначены для измерения дозврывоопасных концентраций метана и пропана в воздухе рабочей зоны, а также для передачи измерительной информации внешним устройствам в аналоговой и цифровой форме и выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство.

Описание средства измерений

Газоанализаторы являются стационарными автоматическими одноканальными приборами непрерывного действия.

Принцип действия газоанализаторов – оптический абсорбционный.

Конструктивно газоанализаторы состоят из цилиндрического корпуса, двух крышек и двух кабельных вводов, и представляют собой взрывонепроницаемую оболочку. Корпус газоанализаторов изготовлен из окрашенного алюминия. Корпус состоит из электронно-клеммного и оптического отсеков. В электронно-клеммном отсеке имеются отверстия для присоединения взрывозащищенных кабельных вводов, а также контакты клеммной колодки для подключения проводов подачи электропитания и снятия выходных сигналов, а также электронно-управляющая схема газоанализатора. В оптическом отсеке находятся взрывозащищенный сенсор, нагревательный элемент. Оптические элементы сенсора защищены от неблагоприятного воздействия окружающей среды металлическим корпусом и фторопластовым фильтром. Выходные электрические сигналы сенсора обрабатываются электронной схемой, расположенной в электронно-клеммном отсеке. Так же предусмотрена возможность установки в газоанализаторы автоматического обогрева с целью защиты оптических элементов сенсора от образования конденсата и наледи в случае эксплуатации при низких температурах.

Способ отбора пробы - диффузионный.

Газоанализаторы выпускаются в двух исполнениях - ГА-М и ГА-ПР, которые отличаются определяемым компонентом.

Газоанализаторы должны обеспечивать следующие выходные сигналы:

- а. унифицированный аналоговый выходной сигнал (4-20 мА в диапазоне показаний);
- б. цифровой сигнал по каналу связи RS-485 с компьютером;
- в. замыкание контактов реле ("сухой контакт") при срабатывании на превышение 2-х программно-конфигурируемых пороговых уровней концентрации определяемого компонента – "Порог 1" (контакты 3-4 клеммника XS2), "Порог 2" (контакты 1-2 клеммника XS2).
- г. замыкание контактов реле ("сухой контакт") (контакты 7-8 клеммника XS1) при неисправности газоанализатора.

Общий вид газоанализаторов представлен на рисунке 1 - 2.

Место и метод пломбирования от несанкционированного доступа представлены на рисунке 3.

Пример идентификационной таблички представлен на рисунке 4.

Нанесения знака поверки на газоанализатор не предусмотрено. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в соответствии с действующим законодательством.



Рисунок 1 – Общий вид газоанализаторов «АЛМАЗ-СПЕКТР» с кронштейном

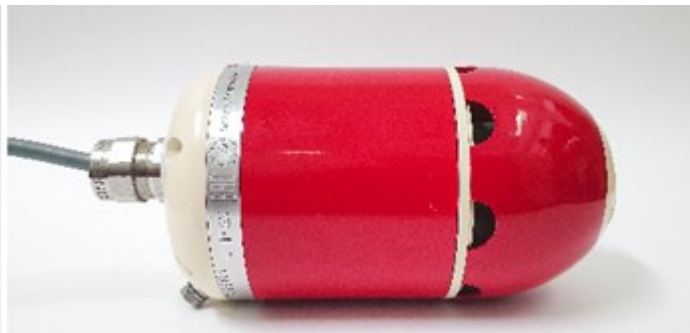


Рисунок 2 – Общий вид газоанализаторов «АЛМАЗ-СПЕКТР» без кронштейна

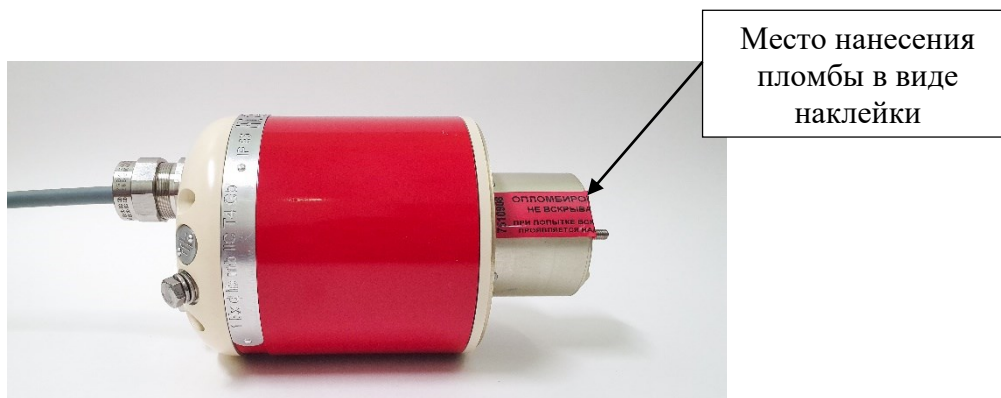


Рисунок 3 - Газоанализаторы «АЛМАЗ-СПЕКТР» с пломбой



Рисунок 4 – Общий вид идентификационной таблички и места нанесения знака утверждения типа для газоанализаторов «АЛМАЗ-СПЕКТР»

Программное обеспечение

Газоанализаторы имеют встроенное программное обеспечение (ПО). Встроенное ПО газоанализаторов разработано изготовителем газоанализаторов специально для решения задачи измерения концентрации горючих газов и обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- передачу измерительной информации от первичного измерительного преобразователя (сенсора) газоанализаторов ко вторичному измерительному преобразователю (процессору обработки информации) газоанализаторов;
- обработку измерительной информации, поступающей от сенсора, в процессоре обработки информации газоанализатора;

- формирование аналоговых токовых выходных сигналов измерительной информации;
- отображение результатов измерений концентрации определяемого компонента (газа) в анализируемой газовой смеси на экране компьютера;
- самодиагностику аппаратной части анализаторов;
- выдачу трех дискретных релейных выходных сигналов состояния газоанализаторов ("Порог 1", "Порог 2", "Отказ") и отображение сообщений, соответствующих выходным сигналам состояния, на экране компьютера.

Встроенное ПО газоанализаторов реализует следующие расчетные алгоритмы:

- вычисление значений концентрации компонента (газа) в анализируемой газовой смеси;
- сравнение результатов измерений концентрации определяемого компонента (газа) в анализируемой газовой смеси с предварительно заданными пороговыми и максимально допустимыми значениями концентрации этого компонента (газа).

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Наименование характеристики	Значение	
	Идентификационное наименование ПО	СН4
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	00-01	00-02
Цифровой идентификатор ПО	987654	641375

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Основные метрологические характеристики

Исполнение	Определяемый компонент	Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
				абсолютная	относительная
ГА-М	Метан (СН ₄)	от 0 до 100 % НКПР (от 0 до 4,4 % об.д.)	от 0 до 50 % НКПР включ. (от 0 до 2,2 % об.д. включ.)	±5 % НКПР (±0,22 % об.д.)	-
			св. 50 до 100 % НКПР (св. 2,2 до 4,4 % об.д.)	-	±10 %
ГА-ПР	Пропан (С ₃ Н ₈)	от 0 до 100 % НКПР (от 0 до 1,7 % об.д.)	от 0 до 50 % НКПР включ. (от 0 до 0,85 % об.д. включ.)	±5 % НКПР (±0,085 % об.д.)	-
			св. 50 до 100 % НКПР (св. 0,85 до 1,7 % об.д.)	-	±10 %

¹⁾ Значения НКПР указаны в соответствии с ГОСТ 30852.19-2002;
- время установления показаний по уровню T_{0,9} не более 20 секунд.

Таблица 3 –Дополнительные метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды от нормальной на каждые 10°С, в долях от предела допускаемой основной погрешности	±0,1
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения относительной влажности окружающей среды от нормальной на каждые 10 %, в долях от предела допускаемой основной погрешности	±0,2
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализаторов от влияния изменения атмосферного давления от нормальной на каждые 10 кПа, в долях от предела допускаемой основной погрешности	±0,5

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры (диаметр × ширина ¹⁾ × длина), мм, не более:	105×140×225
Масса ¹⁾ , кг, не более	5
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С - относительная влажность окружающего воздуха (без конденсации влаги), % - атмосферное давление, кПа	от -10 (-60 ²⁾) до +65 от 20 до 80 от 84 до 107
Время прогрева, мин., не более	10
Напряжение питания постоянного тока, В	от 18 до 32
Потребляемая мощность, Вт, не более	15
Маркировка взрывозащиты	1Ex d mb [ib] ПС Т4 Gb
Степень защиты по ГОСТ 14254-15:	IP 65
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	35 000
Средний срок службы ³⁾ , лет, не менее	10
<p>1) - с кронштейном; 2) - при условии комплектации автоматического обогрева; 3) - без учета чувствительного элемента (сенсора).</p>	

Знак утверждения типа

наноситься на идентификационную табличку, закрепленную на газоанализаторе, а также на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Газоанализатор «Алмаз-Спектр»	-	1 шт.
Паспорт	КДБВ.407729.022 ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	КДБВ.407729.022 РЭ	1 экз.
Переносной носитель информации с Руководством по эксплуатации и Программным обеспечением	-	1 шт.
Комплект клеммников	-	1 шт.
Кронштейн	КДБВ.733151.001	1 шт.
Комплект крепежа	-	1 шт.

Продолжение таблицы 5

Наименование	Обозначение	Количество
Насадка*	СКЯТ.441586.208	1 шт.
Кабель для подключения ПК*	-	1 шт.
Тара*	-	1 комплект
* - по заказу.		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в п. 2,5 документа «КДБВ.407729.022РЭ. Газоанализаторы «АЛМАЗ-СПЕКТР» Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к газоанализаторам «АЛМАЗ-СПЕКТР»:

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «31» декабря 2020 г. № 2315 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах»

ГОСТ 13320-81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия

ТУ 4215-028-07566348-2019 Газоанализаторы «Алмаз-Спектр». Технические условия.

Изготовитель

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алмаз»

(АО «НПП «Алмаз») г. Саратов, ИНН 6453119615

Адрес: 410033, г. Саратов, ул. Панфилова, 1

Тел./Факс: +7 (452) 63-35-58, 48-00-39

Web сайт: <http://www.almaz-rpe.ru>

E-mail: almaz@overta.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»

(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

Адрес: 119530, г. Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. VII, комн.6

Телефон: +7 (495) 481-33-80

E-mail: info@prommashtest.ru

Регистрационный номер RA.RU.312126 в Реестре аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений Росаккредитации